THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

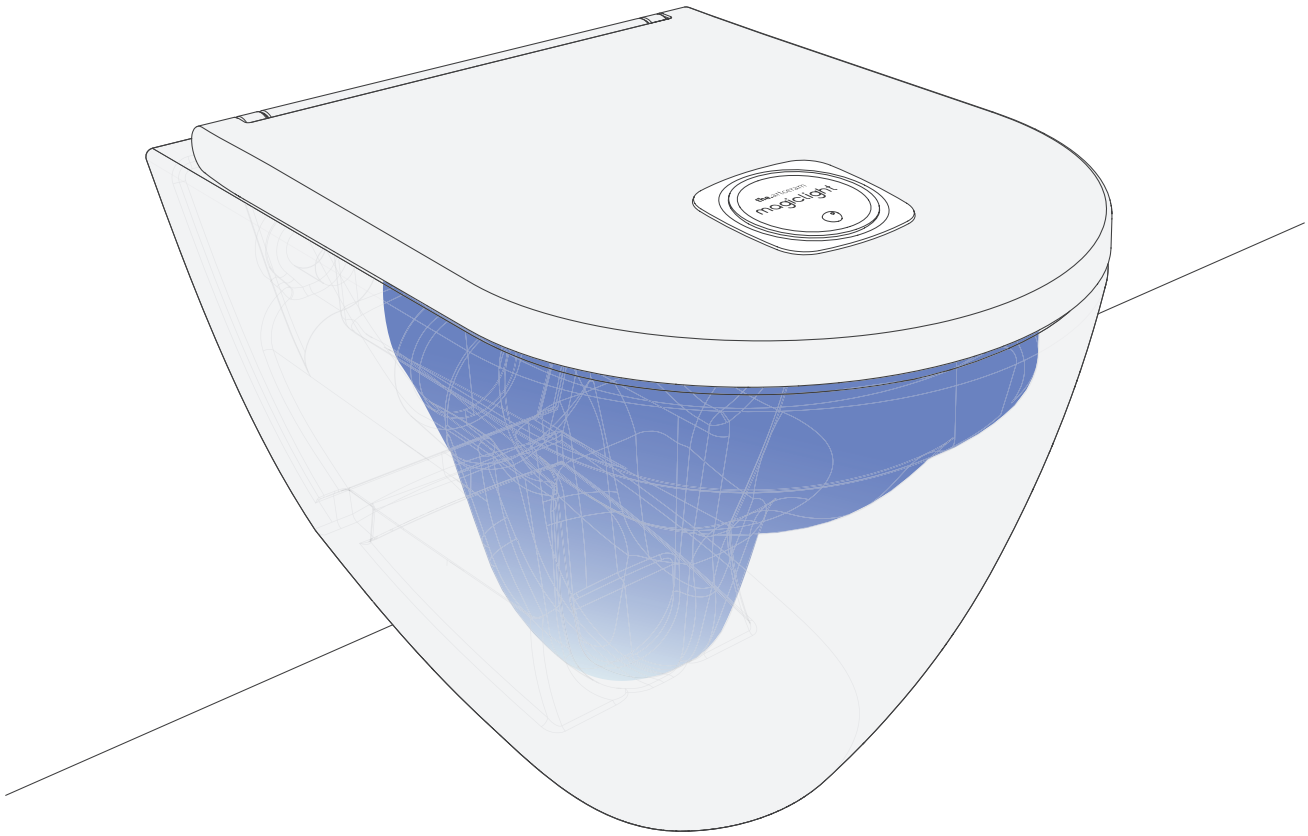

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

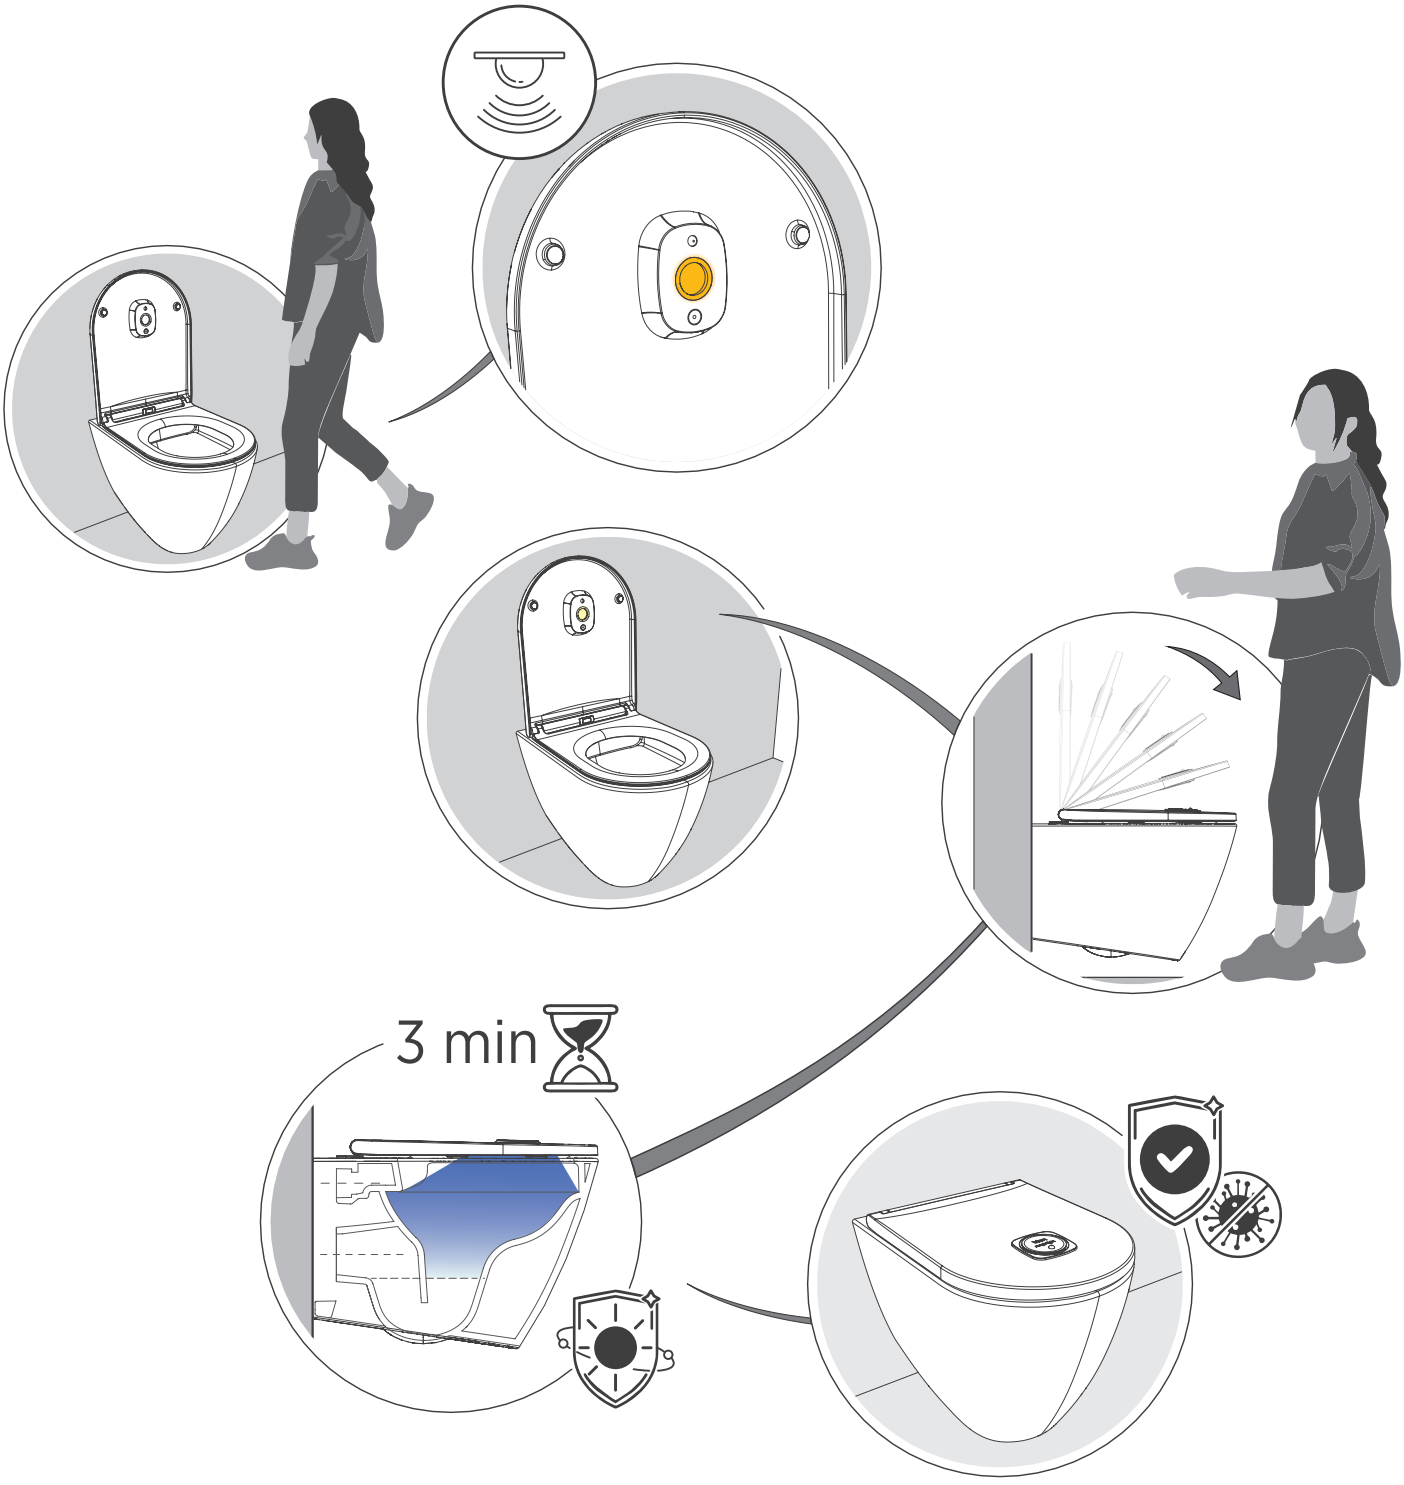

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

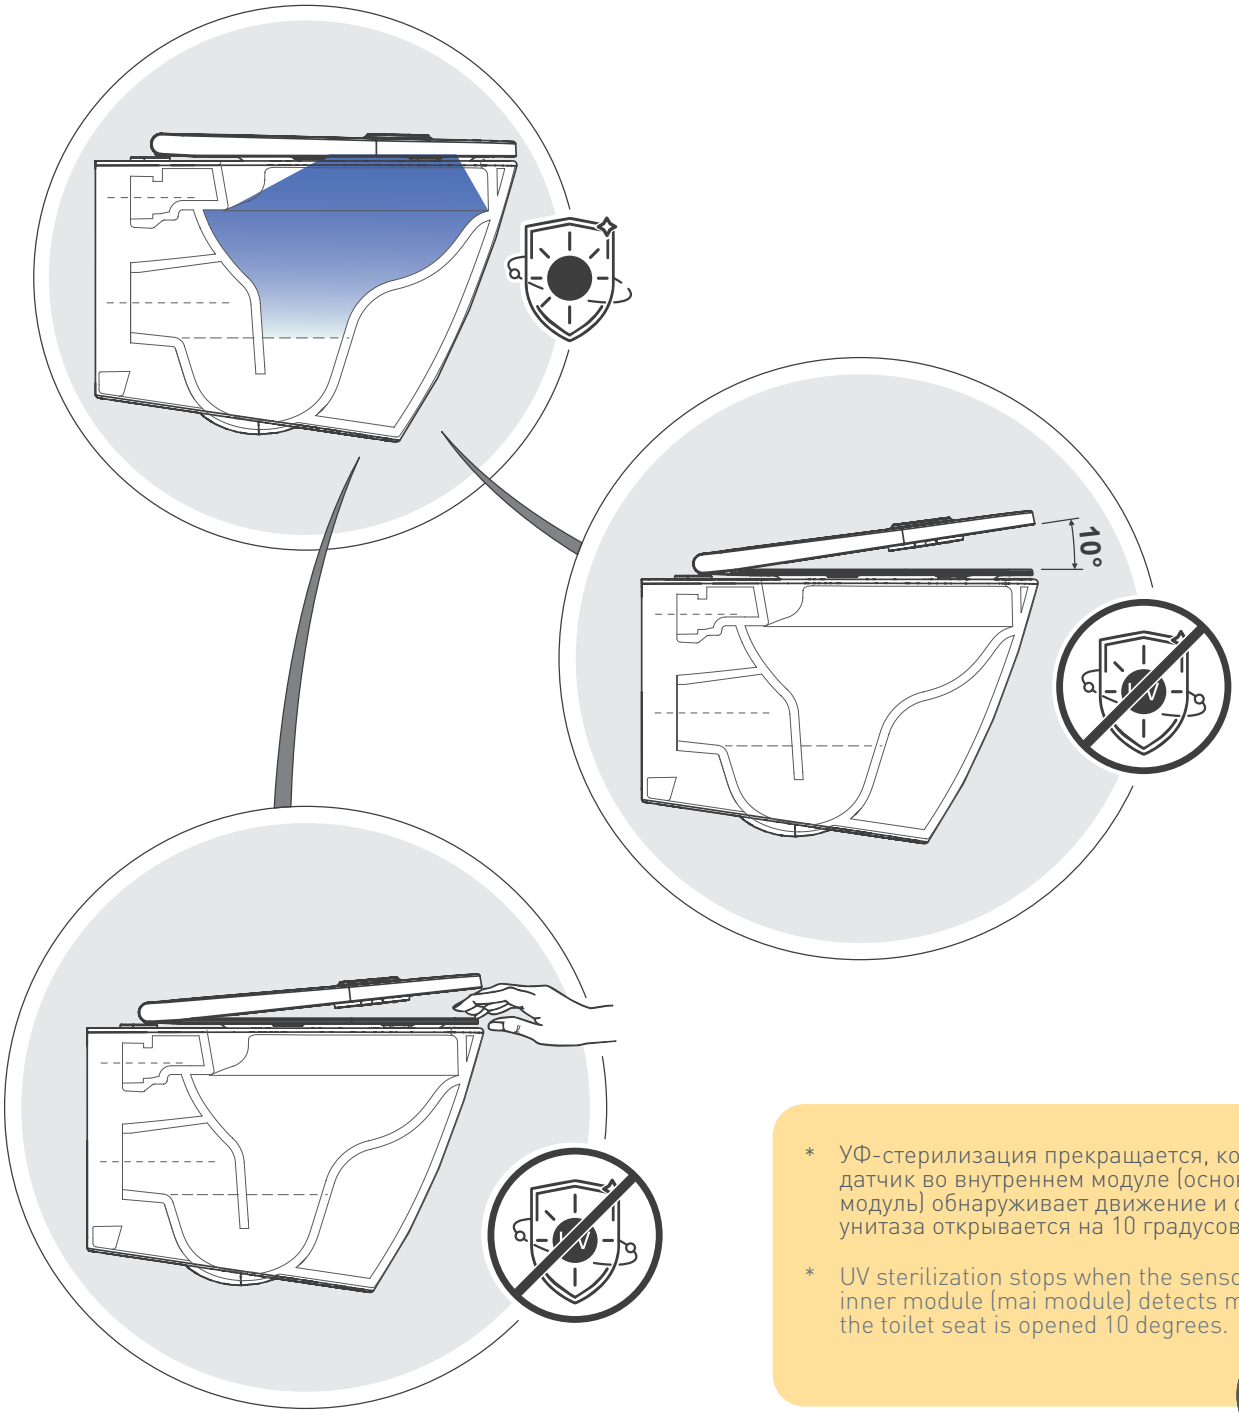

* УФ-стерилизация прекращается, когда датчик во внутреннем модуле (основной модуль) обнаруживает движение и сиденье унитаза открывается на 10 градусов.

* UV sterilization stops when the sensor in the inner module (mai module) detects motion and the toilet seat is opened 10 degrees.

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

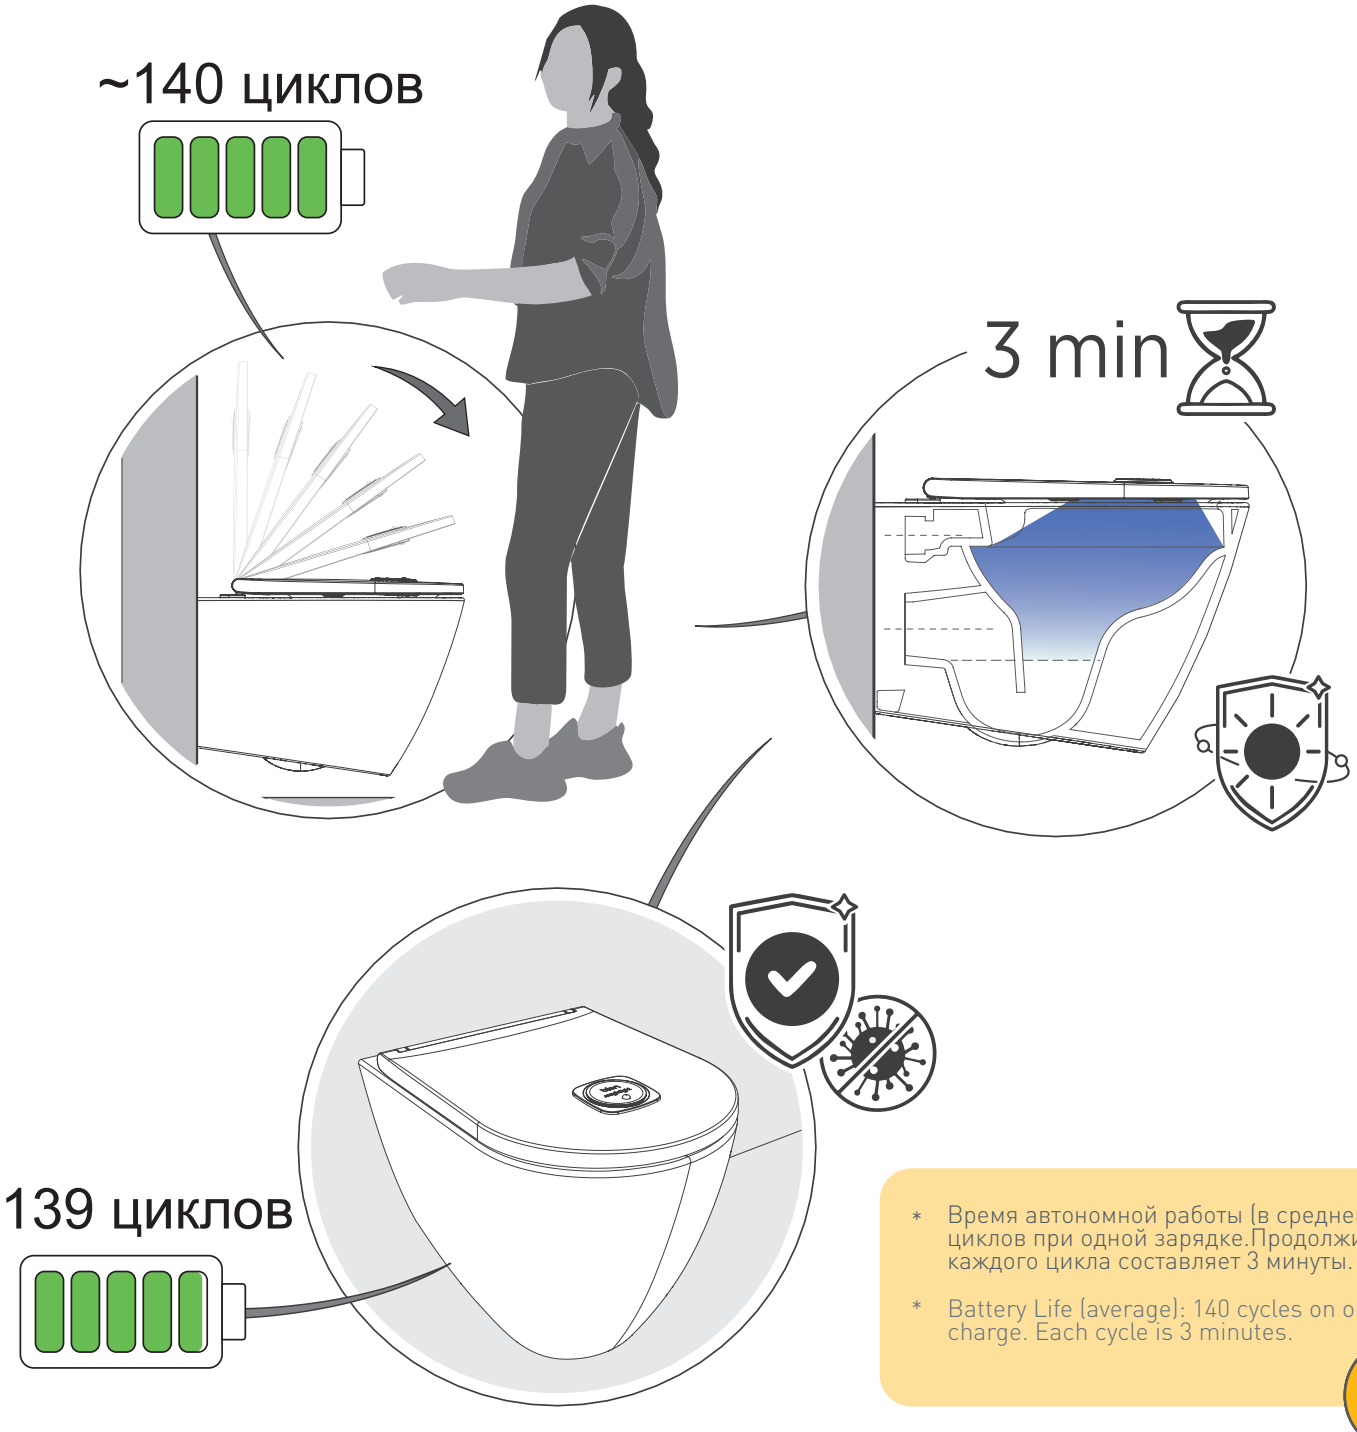

* Время автономной работы (в среднем): 140 циклов при одной зарядке.Продолжительность каждого цикла составляет 3 минуты.
* Battery Life (average): 140 cycles on one charge. Each cycle is 3 minutes.

TheArtceram SRL.
Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

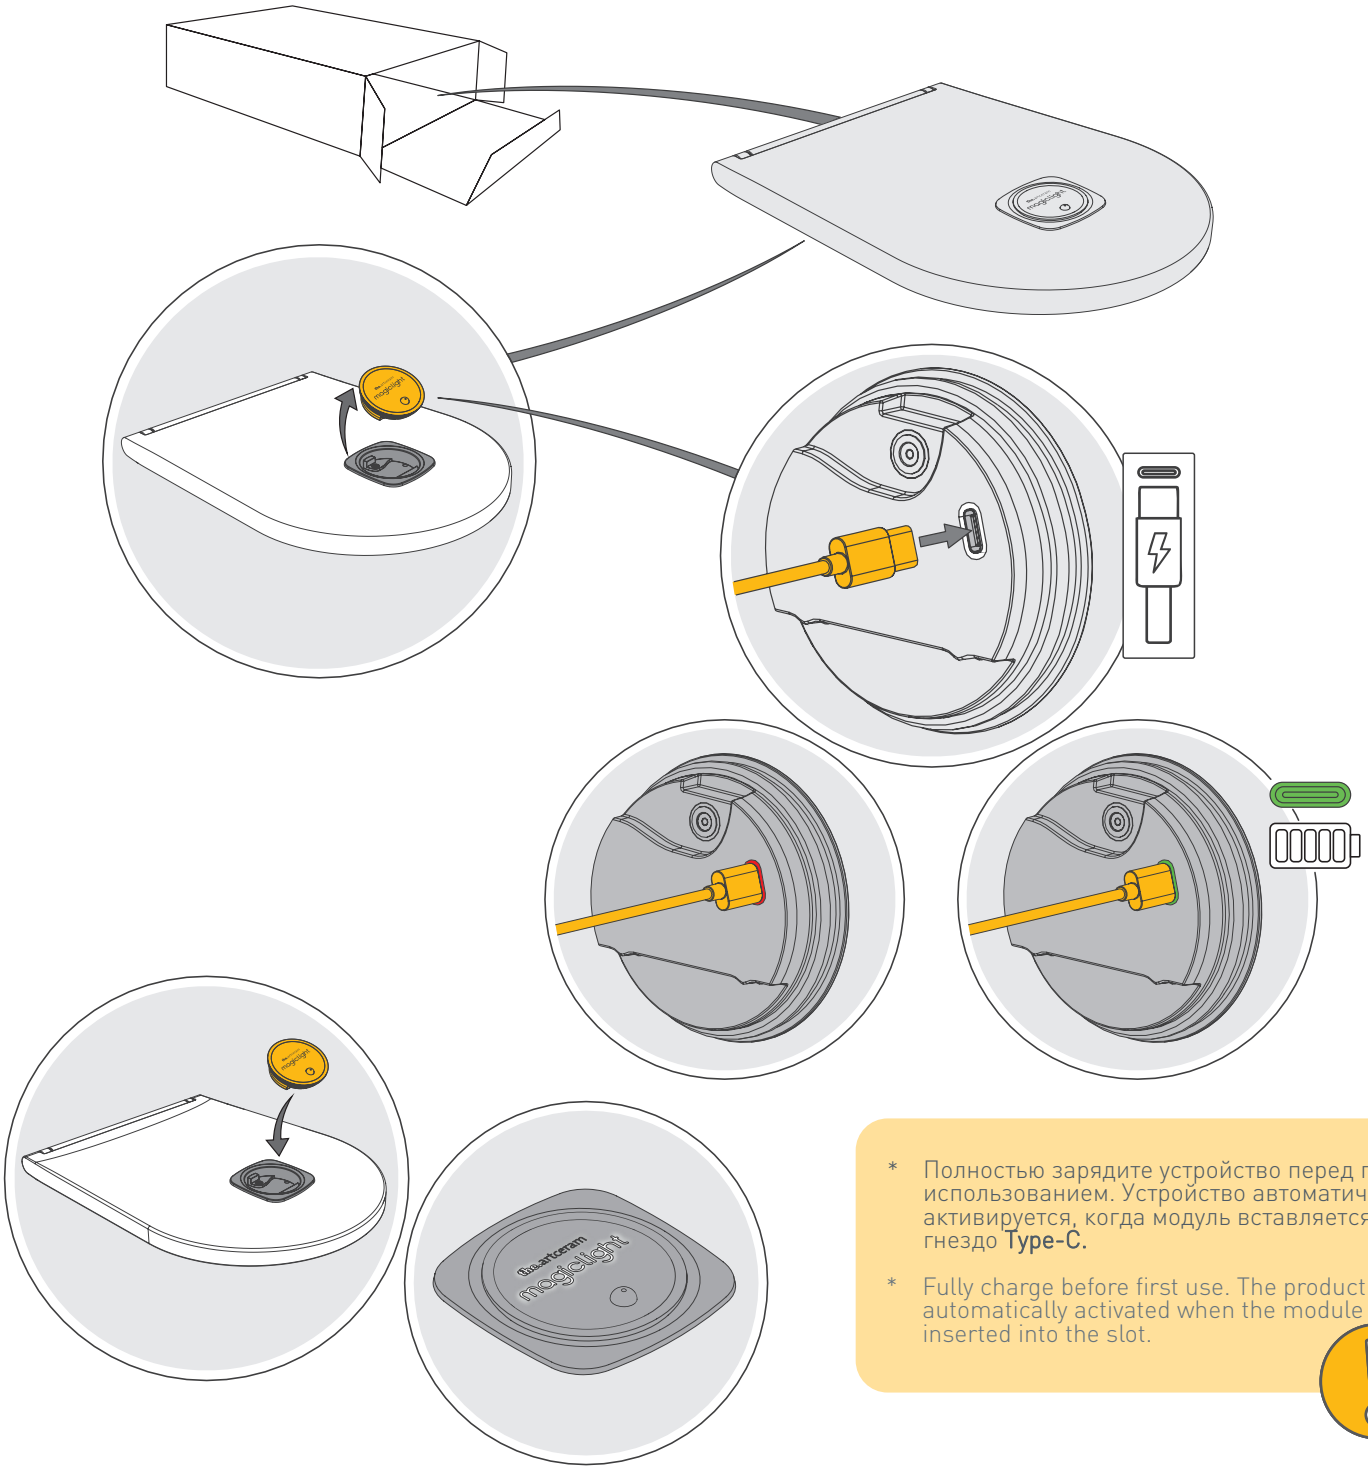

* Полностью зарядите устройство перед первым использованием. Устройство автоматически активируется, когда модуль вставляется в гнездо Type-C.

* Fully charge before first use. The product is automatically activated when the module is inserted into the slot.

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

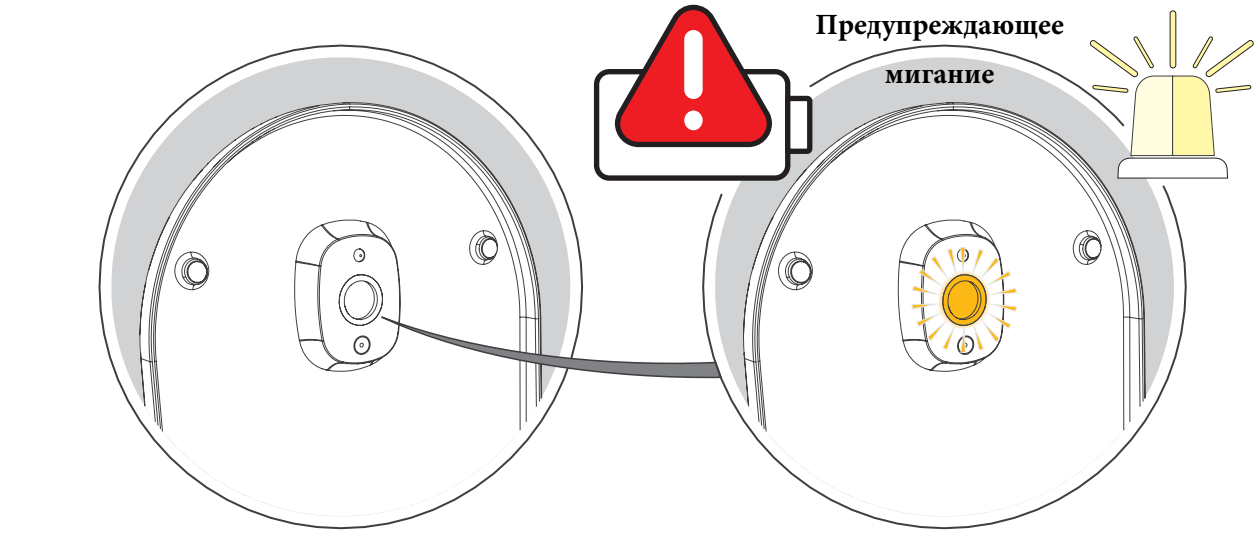

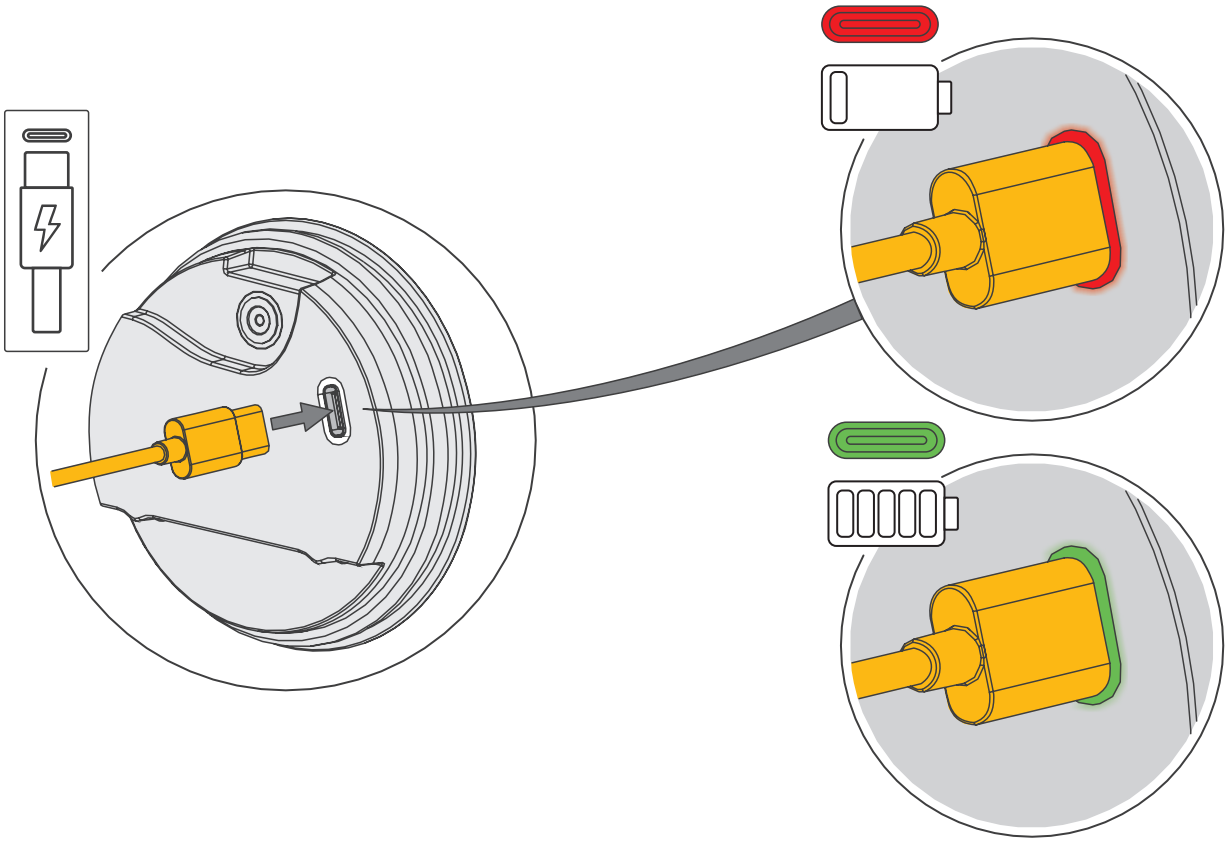

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

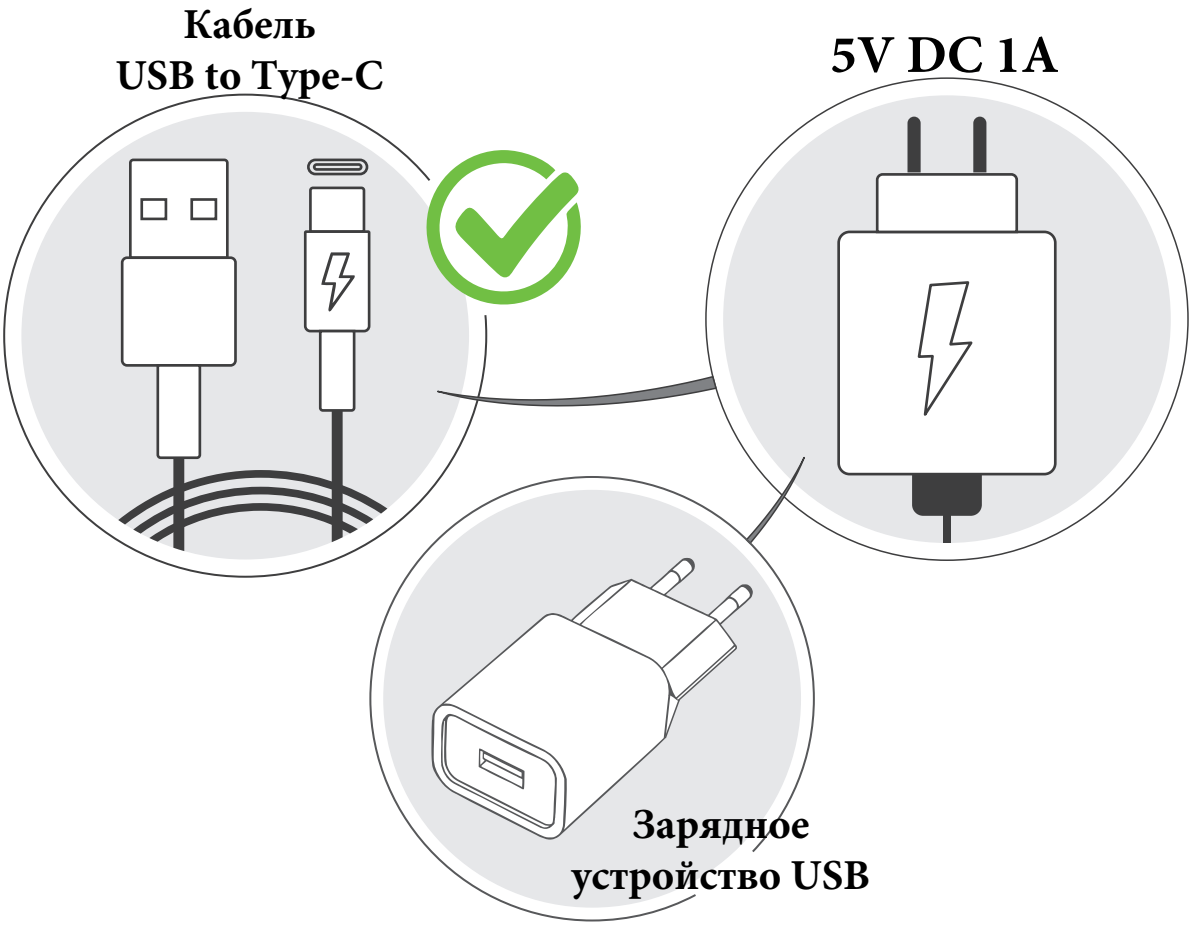

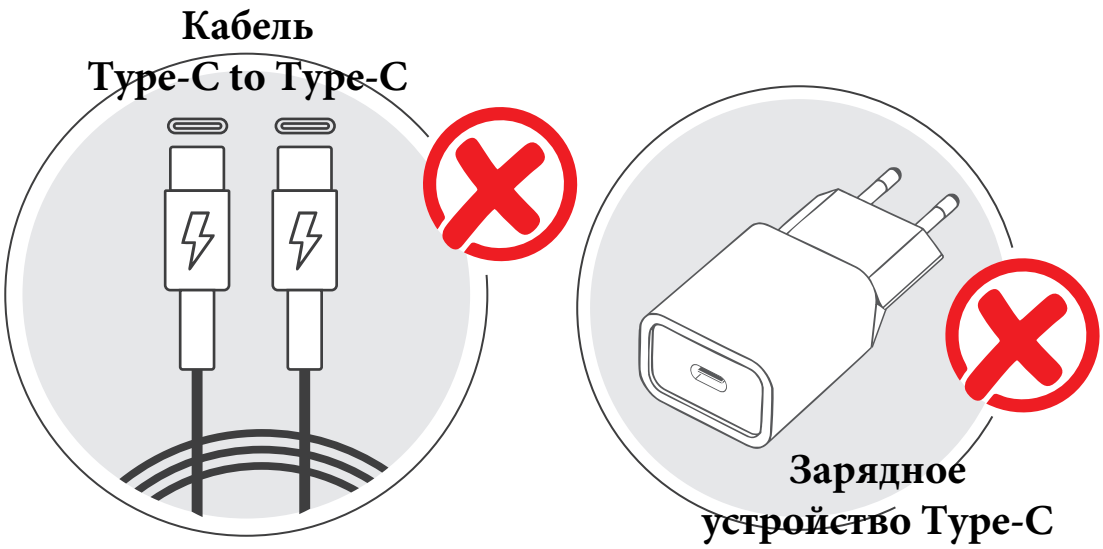

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

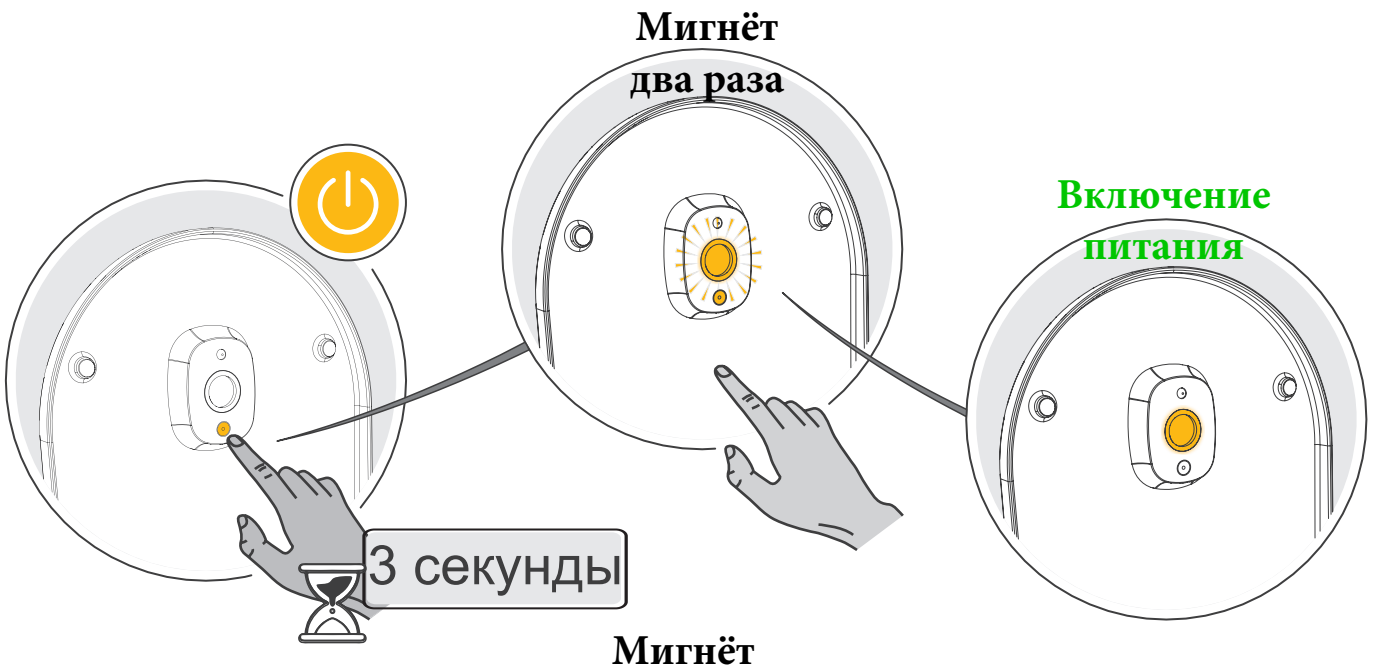

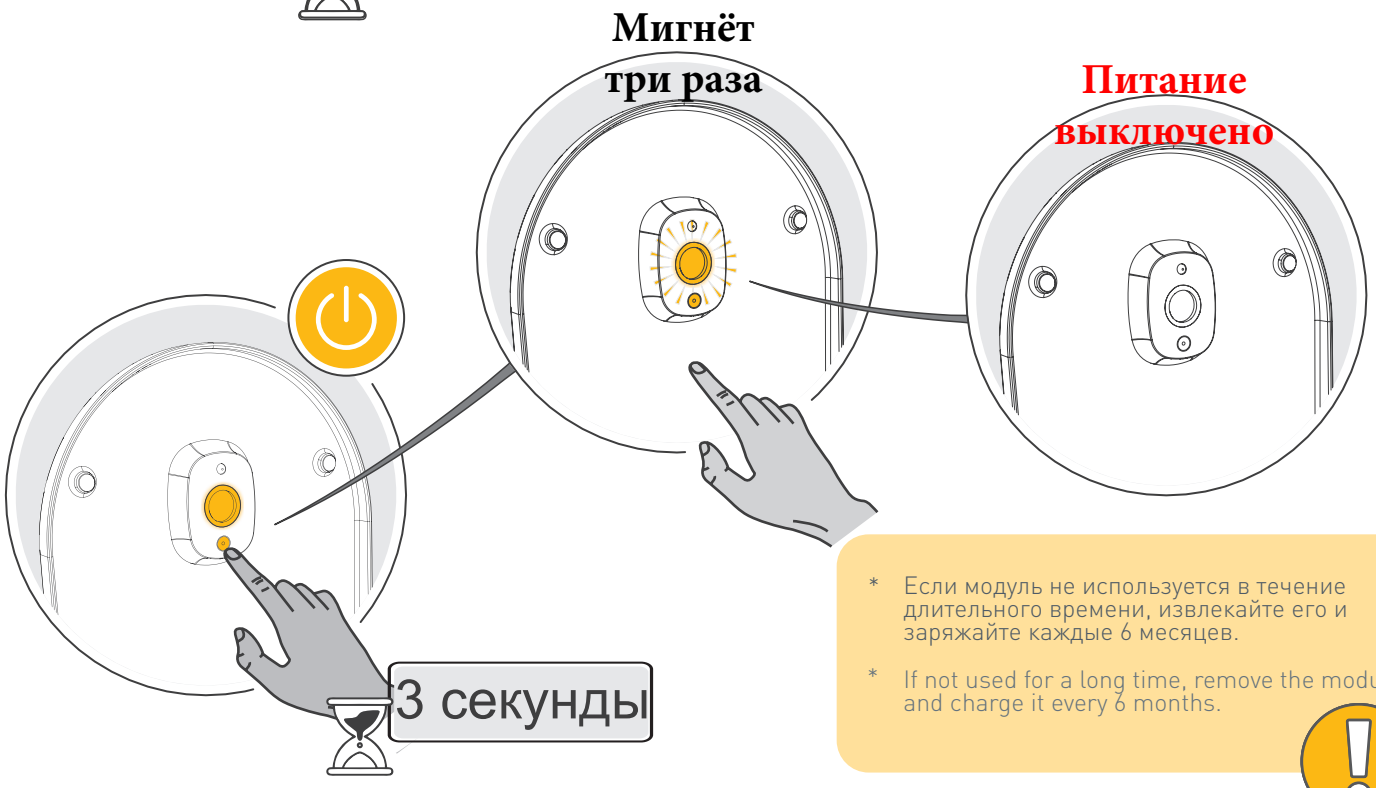

* Если модуль не используется в течение длительного времени, извлекайте его и заряжайте каждые 6 месяцев.

* If not used for a long time, remove the module and charge it every 6 months.

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

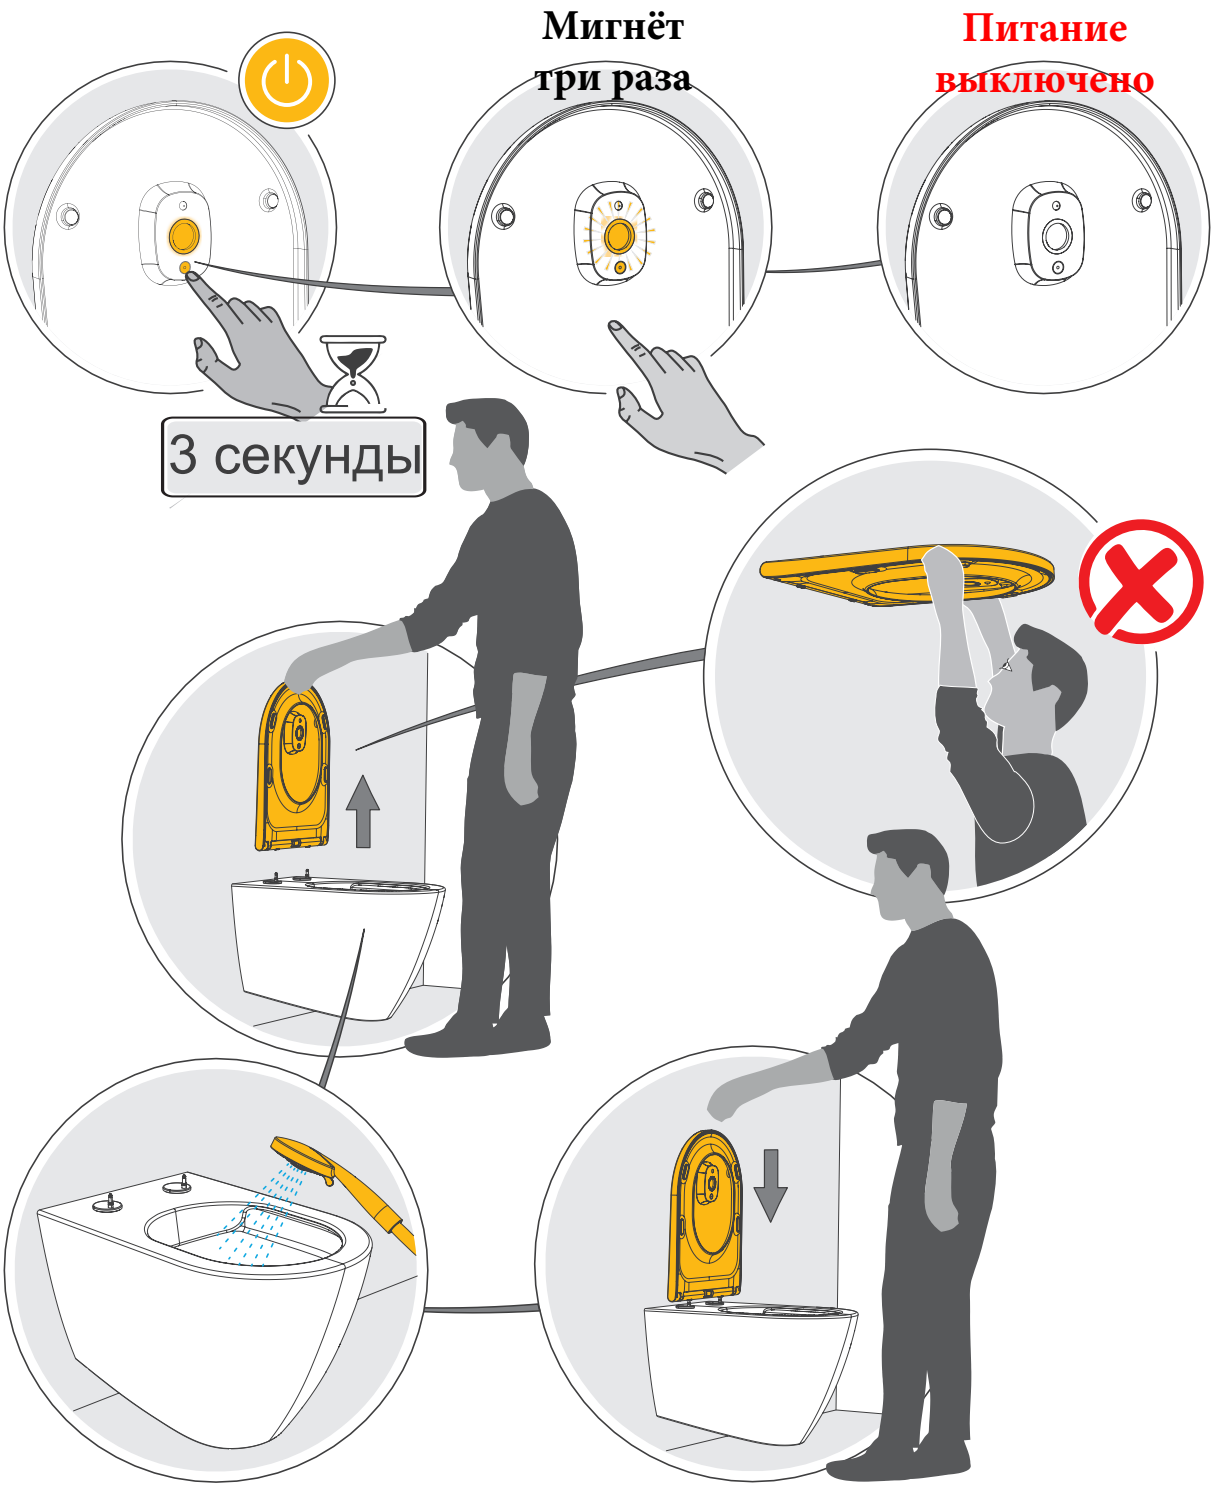

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

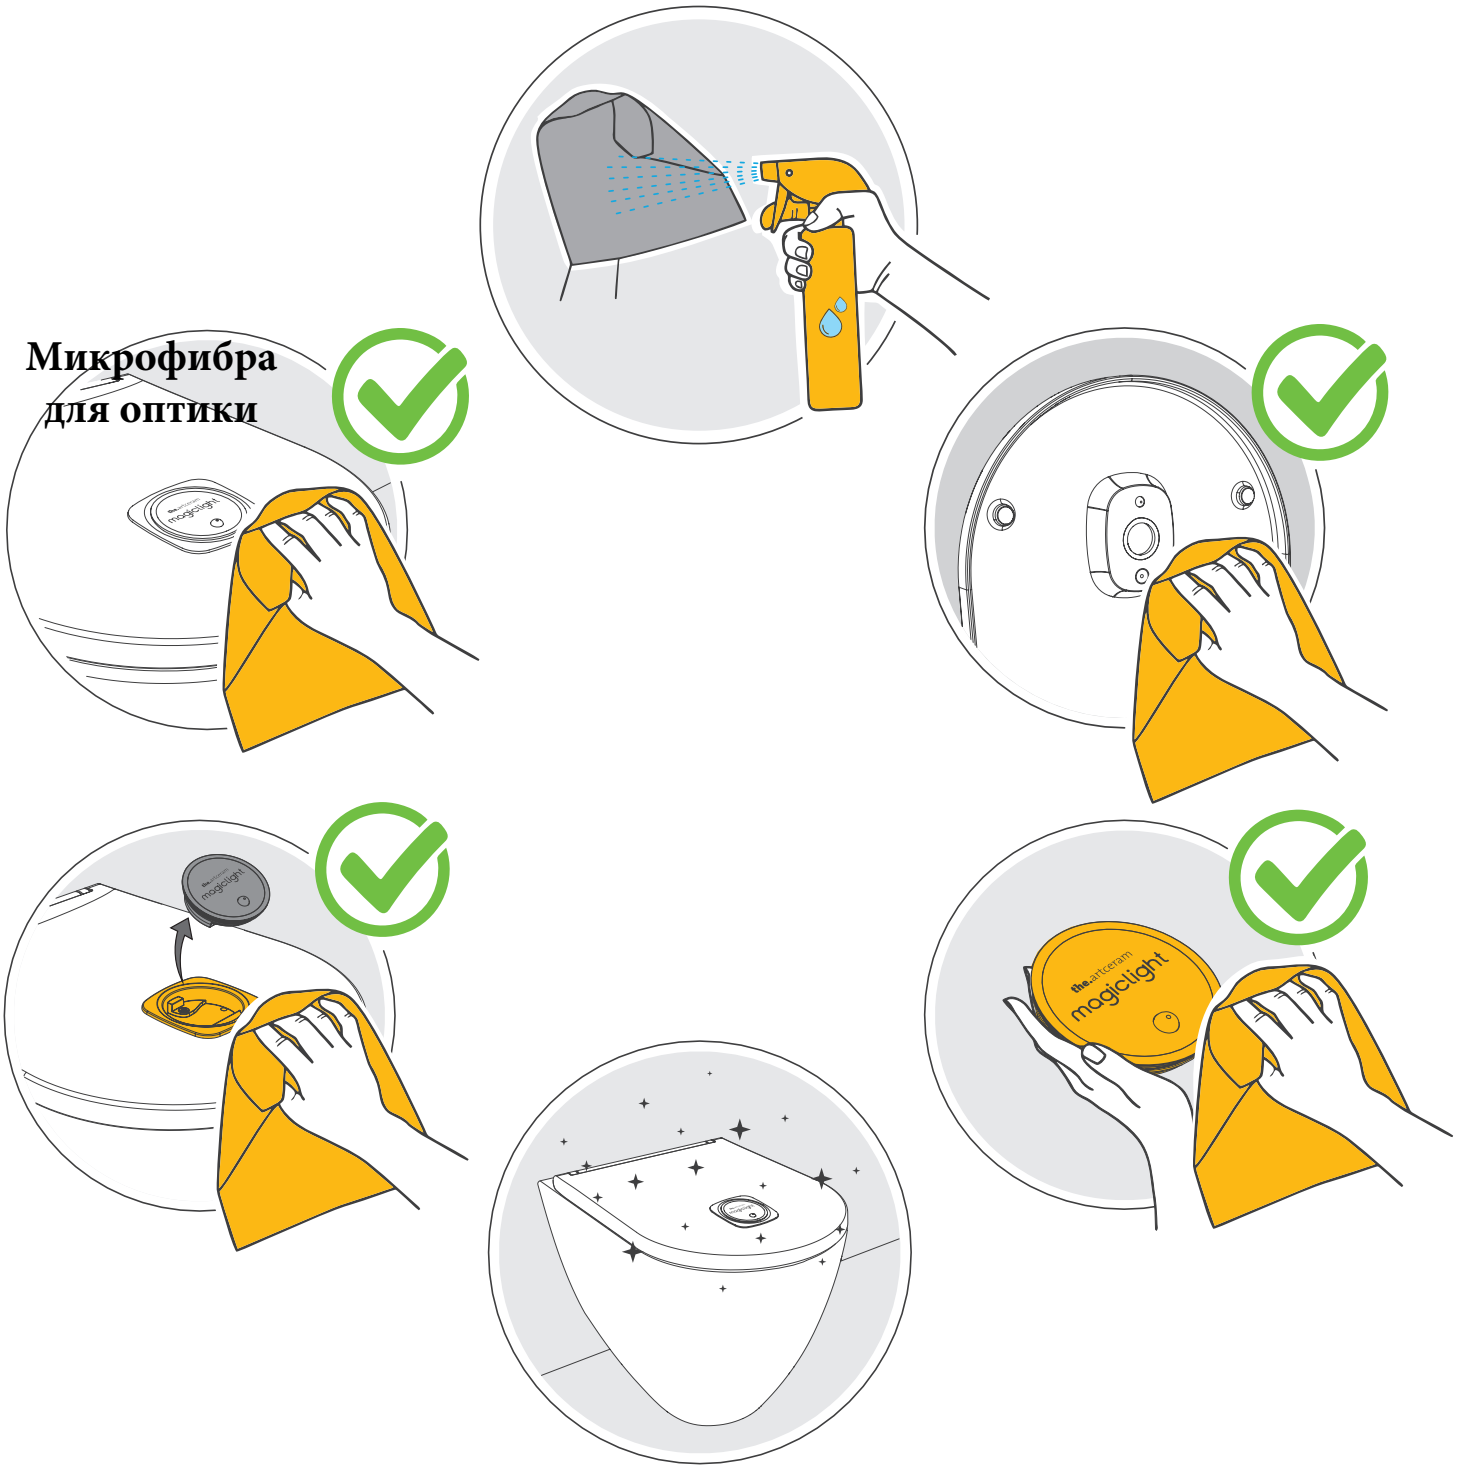

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

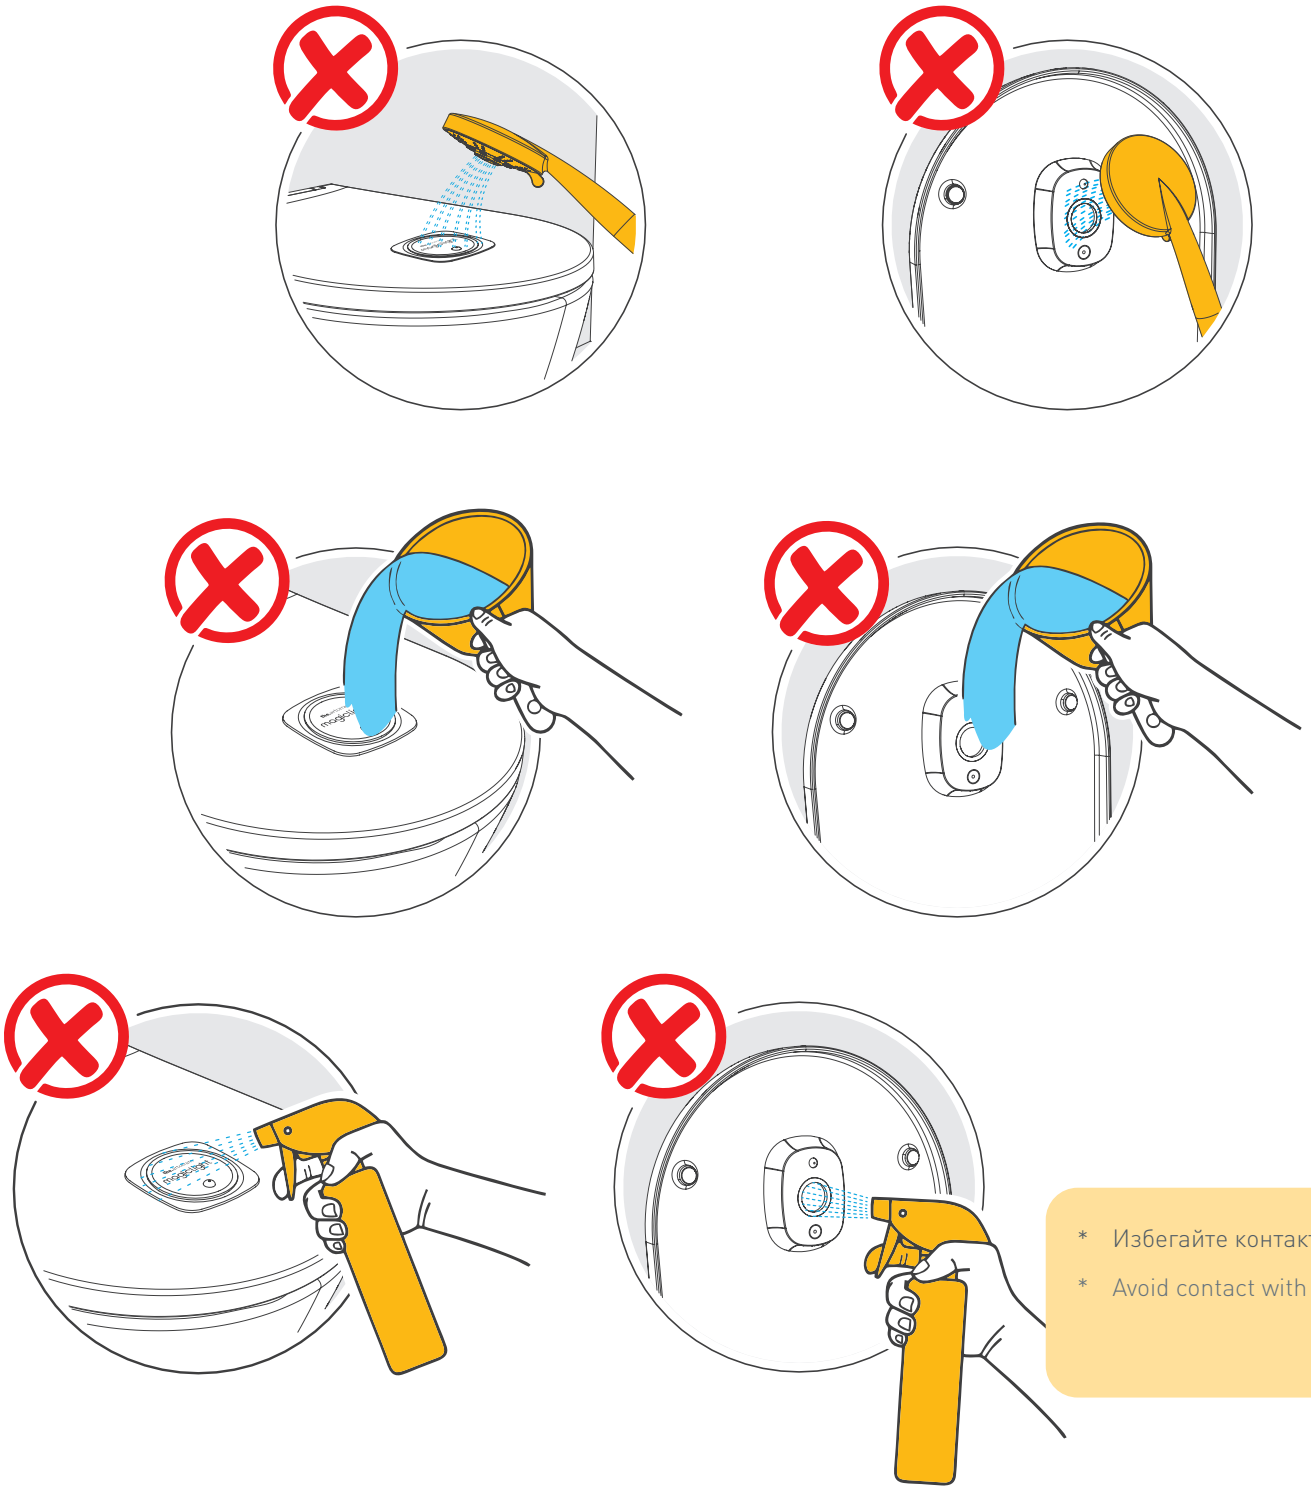

* Избегайте контакта с водой
* Avoid contact with water.

TheArtceram SRL.

Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it